

IDENTIFICATION OF PARTS
BEZEICHNUNG DER TEILE
IDENTIFICATION DES
PARTIES
COMPONENTI
IDENTIFICACION DE
LAS PARTES
BENOEIING VAN DE
ONDERDELEN
BESKRIVELSE




Fig. 1/Abb. 1

DIRECTIONS FOR USE
GEBRAUCHSANWEISUNG
MODE D'EMPLOI
ISTRUZIONI PER L'USO
INSTRUCCIONES DE USO
GEBRUIKSANWIJZING
BRUGSANVISNING




Fig. 2/Abb. 2

Marks
Markierungen
Markieren
Segni
Marcas
Markeringen

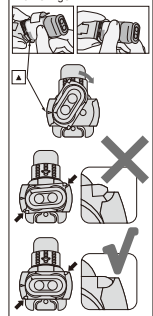


Fig. 3/Abb. 3




Fig. 4/Abb. 4




Fig. 5/Abb. 5




Fig. 6/Abb. 6




Fig. 7/Abb. 7




Fig. 8/Abb. 8




Fig. 9/Abb. 9

Paste Pak Dispenser

For use only by a dental professional in the recommended indications.

Paste Pak Delivery System consists of Paste Pak Dispenser and the special Paste Pak cartridge. Paste Pak Dispenser enables you to dispense material easily and correctly from the cartridge.

INDICATIONS FOR USE

Dispensing material from GC special Paste Pak cartridges.

- IDENTIFICATION OF PARTS**
(Paste Pak Cartridge)
- Cover 2. Inner plunger 3. Cartridge tip (Paste Pak Dispenser)
 - Piston 5. Adjusting guide 6. Lever 7. Sliding block 8. Piston release (Fig. 1)

- Before use**
- Remove the fixing tape placed between the main part and lever of the dispenser.
 - Remove the V shaped board from the underside of the dispenser.

DIRECTIONS FOR USE

- Make sure that the piston is completely retracted into the dispenser. (Fig. 2)
Note:
To retract the piston, push the piston release and at the same time pull the sliding block (on the underside of the dispenser) with fingers.
- Paste Pak Cartridge Loading (Fig. 3)
 - Ensure the ▲ mark on the cartridge lines up with the ▲ mark on the Paste Pak Dispenser as illustrated.
 - Then turn the cartridge fully to the right position.
Note:
To remove the cartridge, retract the piston fully and turn the cartridge back to the marked positions.
- After cartridge loading, push the piston release forward until it stops. (Fig. 4)
 - Push the piston release forward.
 - Do not push the upper side.
- Remove the cartridge cover. (Fig. 5)
 - Depress the lever to dispense the required amounts of paste onto the mixing pad.
Note:
1) Before dispensing the first time from a new cartridge or after a long interval in between use, bleed the pastes from the cartridge. (Fig. 6)
 - The adjusting guide can be moved forwards or backwards to change the quantity of material to be dispensed. (Fig. 7)
 - Position of adjusting guide for one inlay.
 - Position of adjusting guide for one crown.
 - While depressing the lever (Fig. 8-1), level and cut off the extruded material from the cartridge tips by moving the cartridge and dispenser to an upright position on the mixing pad (Fig. 8-2).
When the lever is released after dispensing, residual pastes at the cartridge tips are retracted into the cartridge. Clean the cartridge tip and replace the cartridge cover. (Fig. 8)
Note:
1) The amount of residual material in the cartridge can be confirmed by the position of the sliding block on the underside of the dispenser. If the cartridge cylinders are translucent, the residual amount can also be confirmed by the position of the inner plunger seen through the cylinders.
 - Do not drop the dispenser with the cartridge. Otherwise the cartridge may be damaged.

Cleaning / Sterilization of Paste Pak Dispenser

- Clean the dispenser and adjusting guide with gauze soaked in alcohol.
- The dispenser may be steam autoclaved at 121-135°C (250-275°F) for 10 to 30 minutes or disinfected using alcohol. (Please remove the adjusting guide and the cartridge before autoclaving the dispenser). The use of various chemical disinfectants / sterilants may cause damage to the dispenser and therefore is not recommended.
Note:
After autoclaving, the piston release of the dispenser may not easily be moved forwards and backwards by fingers. In such a case, slide the piston release forward until it stops. Apply a very small quantity of petroleum jelly onto the entire surface of the piston.
Do not apply excess petroleum jelly. Then move the piston release back and forth a few times to ensure smooth movement.

PACKAGE

1 piece

CAUTION

- In rare cases metal may cause sensitivity to some persons. If such reactions are experienced, discontinue the use of the product (nickel-plated aluminum) and refer to a physician.
- Store Paste Pak Dispenser away from chemicals such as iodine tincture containing halogen element. Otherwise the dispenser may discolor.
- Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:
<http://www.gceurope.com>
or for The Americas
<http://www.gcamerica.com>
They can also be obtained from your supplier.

Undesired effects - Reporting:
If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country accessible through the following link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
as well as to our internal vigilance system: vigilance@gc.dental
In this way you will contribute to improve the safety of this product.

UK Responsible Person
GC UNITED KINGDOM LTD.
Coopers Court Newport Pagnell, Buckinghamshire, MK16 8JS United Kingdom

Last revised: 08/2022

Prior to use, carefully read the instructions for use. **EN**

Paste Pak Dispenser

Nur von zahnärztlichem Fachpersonal für die genannten Anwendungsbereiche verwenden.

Das Paste Pak Delivery System besteht aus einem Paste Pak Dispenser und einer speziellen Paste Pak Kartusche. Der Paste Pak Dispenser ermöglicht ein leichtes und korrektes Ausdrücken des Materials aus der Kartusche heraus.

INDIKATIONEN ZUR ANWENDUNG

Ausdrücken von Material aus den geeigneten Paste Pak Kartuschen.

- BEZEICHNUNG DER TEILE**
(Paste Pak Kartusche)
- Deckel 2. Innerer Kolben 3. Kartuschen-Spitze (Paste Pak Dispenser)
 - Kolben 5. Einstellhilfe 6. Hebel 7. Sperrhebel 8. Freigabehebel (Abb. 1)

- Vor der Anwendung**
- Den Transportschutz zwischen Dispenserhebel und Dispenserkörper entfernen.
 - Den V-förmigen Karton an der Unterseite des Dispensers entfernen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Sicherstellen, dass der Kolben komplett in den Dispenser zurückgezogen wurde. (Abb. 2)
Beachten:
Um den Kolben zurück zu ziehen den Freigabehebel drücken und gleichzeitig das Glasteilstück an der Unterseite des Dispensers zurückziehen.
- Einsetzen der Paste Pak Kartusche (Abb. 3)
 - Sicherstellen, dass sich die Markierung ▲ auf der Kartusche und die Markierung ▲ auf dem Paste Pak Dispenser wie abgebildet in einer Linie befinden.
 - Die Paste Pak Kartusche nach rechts in Position drehen.
Beachten:
Um die Kartusche herauszunehmen, den Kolben komplett zurückziehen und die Kartusche in die markierte Position zurückdrehen.
- Nach dem Einsetzen der Kartusche den Freigabehebel bis zum Anschlag vorschieben (Kartuschendeckel nicht abnehmen). (Abb. 4)
 - Den Freigabehebel mit dem Daumen in der Mitte nach vorne schieben, bis die Kartusche nach vorne b. Schieb mit dem Freigabehebel an der Oberseite nach vorne, blockiert er.
- Den Kartuschendeckel entfernen. (Abb. 5)

- Den Hebel drücken, um die erforderliche Menge der Paste auf den Anmischblock auszurücken.
Beachten:
1) Vor der ersten Verwendung einer neuen Kartusche, oder bei längerer Zeitspanne zwischen zwei Anwendungen, Pasten aus der Kartusche auszurücken. (Abb. 6)
- Der Einstellhebel kann vor oder zurück bewegt werden, um die auszubringende Materialmenge anzupassen. (Abb. 7)
 - Stellung des Einstellhebels für ein Inlay.
 - Position des Einstellhebels für eine Krone.
- Während der Hebel gedrückt wird. (Abb. 8-1), das ausgepresste Material abstreifen, indem Kartusche und Applikator auf dem Anmischblock in senkrechte Stellung gebracht werden. (Abb. 8-2)
Wird der Hebel nach dem Ausbringen entlastet, werden verbleibende Pastenanteile an den Kartuschenspitzen zurück in die Kartusche gezogen. Kartuschenspitzen und Kartuschenverschluss wieder aufsetzen. (Abb. 9)
Beachten:
1) Die Menge des restlichen Materials kann der Stellung des Sperrhebels auf der Unterseite des Dispensers entnommen werden. Falls die Kartusche transparent ist, kann auch die Position der in der Kartusche befindlichen Kolben einen Hinweis auf die verbleibende Menge geben.
- Den Dispenser mit der Kartusche nicht fallen lassen, da es sonst zu Beschädigungen der Kartusche kommen kann.

Reinigen / Sterilisation des Paste Pak Dispensers

- Den Dispenser und den Einstellhebel mit in Alkohol getränktem Tuch reinigen.
- Der Dispenser kann bei 121-135°C (250-275°F) für 10 bis 30 Minuten autoclaviert oder mit Alkohol desinfiziert werden (vor dem Autoklavieren des Dispensers den Einstellhebel entfernen). Die Anwendung verschiedener, chemischer Desinfektions- / Sterilisationsmittel kann zu Beschädigungen des Dispensers führen und wird deshalb nicht empfohlen.
Beachten:
Nach dem Autoklavieren kann es vorkommen, dass sich der Freigabehebel des Dispensers mit den Fingern nicht störungsfrei vorwärts und rückwärts schieben lässt. In solchen Fällen die Kolben mit Vaseline benetzen und somit wieder gängig machen.

HANDELSFORM

1 Stück

ACHTUNG

- In seltenen Fällen können Metalle bei einigen Personen Überempfindlichkeiten hervorrufen. Falls solche Reaktionen auftreten, die Anwendung des Produktes (nickelüberzogenes Aluminium) nicht fortsetzen und einen Arzt aufsuchen.
- Bei Kontakt mit jodhaltigen Tinkturen kann eine Verfärbung auftreten!
- Stets Schutzkleidung (PSA) wie Handschuhe, Mundschutz und Schutzbrille tragen.

Einige Produkte, auf die in der vorliegenden Gebrauchsanleitung Bezug genommen wird, können gemäß dem GHS als gefährlich eingestuft sein. Machen Sie sich immer mit den Sicherheitsdatenblättern vertraut, die unter folgendem Link erhältlich sind:
<http://www.gceurope.com>
In Amerika gilt folgender Link:
<http://www.gcamerica.com>
Die Sicherheitsdatenblätter können Sie außerdem bei Ihrem Zulieferer anfordern.

MELDUNG UNERWÜNSCHTER VORKOMMNISSE
Wenn Sie bei der Verwendung des Produktes unerwünschte Nebenwirkungen, Reaktionen oder ähnliche Vorkommnisse feststellen, unabhängig davon, ob sie in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind oder nicht, melden Sie diese bitte umgehend an die entsprechende Meldebörde für Ihr Land, die Sie unter dem Link https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en finden, sowie unsere interne Meldestelle vigilance@gc.dental.
Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die Sicherheit dieses Produktes zu verbessern.

Zuletzt aktualisiert: 08/2022

Vor der Benutzung bitte die Gebrauchsanweisung gründlich lesen! **DE**

Paste Pak Dispenser

Ce produit est réservé à l'Art dentaire selon les recommandations d'usages.

Le système bloc distributeur de pâtes est constitué d'un Distributeur et d'une cartouche de pâtes spéciale. Le bloc distributeur de pâtes (Paste Pak Dispenser) vous permet d'utiliser facilement et proprement le matériau contenu dans la cartouche.

INDICATIONS

S'utilise avec les cartouches de pâtes spéciales GC. Kartuschen.

- IDENTIFICATION DES PARTIES**
(Cartouche de pâtes)
- Capuchon 2. Piston (crémaillère) interne 3. Embout de la cartouche 4. Piston 5. Guide d'ajustement 6. Levier 7. Bloc coulissant 8. taquet de libération (Fig. 1)

- Avant toute utilisation**
- Retirer les attaches placées entre le corps principal et le levier du distributeur.
 - Retirer la partie en forme de V placée en dessous du distributeur.

MODE D'EMPLOI

- Assurez-vous que le piston est complètement enfoncé dans le distributeur. (Fig. 2)
Note:
Pour rétracter le piston, poussez le déclencheur du piston et tirez en même temps le bloc coulissant (sur le dessous du distributeur) avec les doigts.
- Chargement de la cartouche de pâtes (Fig. 3)
 - Assurez-vous que la marque ▲ sur la cartouche s'aligne avec la marque ▲ sur le distributeur Paste Pak comme illustré.
 - Puis, tourner complètement la cartouche vers la droite.
Note:
Pour enlever la cartouche, retirer entièrement le piston et tourner de nouveau la cartouche pour revenir à sa position initiale.
- Une fois la cartouche en place, (ne pas enlever le capuchon de la cartouche), faites glisser le taquet de libération vers l'avant jusqu'à ce qu'il s'arrête. (Fig. 4)
 - Appuyez sur le taquet de libération face à vous
 - Ne pas pousser la partie du dessus.
 - Retirer le bouchon de la cartouche. (Fig.5)
- Appuyez sur le levier pour distribuer la quantité de pâte sur le bloc de mélange.
Note:
1) Avant la première distribution d'une nouvelle cartouche ou après un long intervalle sans utilisation, purger les pâtes de la cartouche. (Fig. 6)

- La guide de réglage peut être déplacé vers l'avant ou vers l'arrière pour changer la quantité de produit distribué. (Fig. 7)
 - Position du guide de réglage pour un inlay.
 - Position du guide de réglage pour une couronne.
- Tout en appuyant sur le levier de distribution (Fig. 8-1), coupez le matériau extrudé en relevant verticalement la cartouche et en frottant les pointes de la cartouche sur le bloc de mélange (Fig. 8-2).
Lorsque le levier est relâché après la distribution, les résidus de pâtes aux extrémités des cartouches se rétractent dans la cartouche. Nettoyez la pointe de la cartouche et remplacez le couvercle de la cartouche. (Fig. 9)
Note:
1) On peut connaître la quantité de matériaux restant dans la cartouche par la position du bloc coulissant sous le distributeur. Si les cylindres de la cartouche sont translucides, le montant de produit restant peut également être confirmé par la position du piston intérieur vu à travers les cylindres.
- Ne pas laisser le distributeur avec la cartouche. Sinon, la cartouche peut être endommagée.

Nettoyage / stérilisation du bloc distributeur de

- Nettoyer le distributeur et le guide d'ajustement avec de la gaze imbibée d'alcool.
- Le distributeur Paste Pak peut être plongé dans un bain de vapeur à 121-135°C (250-275°F) pendant 10 à 30 minutes ou désinfecté à l'alcool. N'oubliez pas de retirer le guide d'ajustement et la cartouche avant le nettoyage du distributeur. L'utilisation de divers désinfectants chimiques / stérilisants, peuvent causer des dommages au distributeur et dès lors, ne sont pas recommandés.
Note:
Après passage à l'autoclave le déverrouillage du distributeur peut ne pas être aisé. Dans ce cas, rétractez complètement le taquet de libération et appliquez un peu de vaseline (gel) sur toute la surface. Puis, actionnez le taquet de libération dans les deux sens plusieurs fois pour obtenir une 'glisse' satisfaisante.

PRESENTATION

1 pièce

AVERTISSEMENT

- Dans de rares cas, le métal peut causer, chez certaines personnes, des réactions allergiques. Si de telles réactions se produisent, cessez d'utiliser ce produit (Nickel plaqué aluminium) et consultez un médecin.
- Conservser le distributeur de pâtes loin de produits chimiques comme la teinture d'iode contenant des éléments halogènes. Le distributeur pourrait être décoloré.
- Un équipement de protection individuel (PPE) comme des gants, masques et lunettes de sécurité doit être porté.

PRESENTATION

1 pièce

AVVERTENZA

- In rari casi i metalli possono provocare sensibilizzazione nelle persone. Se si verificano simili reazioni, interrompere l'uso del prodotto (alluminio nichelato) e consultare un medico.
- Conservare il paste pak dispenser lontano da agenti chimici quali tintura di iodio contenenti elementi alogeni. Altrimenti il dispenser può subire decolorazioni.
- Indossare sempre dispositivi di protezione individuale GHS. Fate costante riferimento alle schede di sicurezza disponibili su:
<http://www.gceurope.com>
o per l'America
<http://www.gcamerica.com>
Possono anche essere richieste al fornitore.

Declaracion d'efectos indésirables:
Si vous avez connaissance d'effets indésirables, de réactions ou d'événements de ce type résultant de l'utilisation de ce produit, y compris ceux non mentionnés dans cette notice, veuillez les signaler directement via le système de vigilance approprié en sélectionnant l'autorité compétente de votre pays accessible via le lien suivant :
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
ainsi qu'à notre système de vigilance interne : vigilance@gc.dental
Vous contribuerez ainsi à améliorer la sécurité de ce produit.

Segnalazione degli effetti indesiderati:
Se si viene a conoscenza di qualsiasi tipo di effetto indesiderato, reazione o eventi simili verificatisi dall'uso di questo prodotto, compresi quelli non elencati in queste istruzioni per l'uso, si prega di segnalarli direttamente al sistema di vigilanza pertinente, selezionando l'autorità competente del proprio paese accessibile attraverso il seguente link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
così come al nostro sistema di vigilanza interna: vigilance@gc.dental
In questo modo si contribuirà a migliorare la sicurezza di questo prodotto.

Última revisión: 08/2022

Avant toute utilisation, lire attentivement les instructions d'emploi. **FR**

Paste Pak Dispenser

Per uso esclusivamente professionale odontoiatrico nelle indicazioni raccomandate.

Il Paste Pak Delivery System si compone del Paste Pak Dispenser e della apposita Paste Pak cartuccia. Il Paste Pak Dispenser permette di distribuire facilmente e correttamente il materiale contenuto nella cartuccia.

INDICAZIONI D'USO

Erogazione del materiale contenuto nelle apposite cartucce GC Paste Pak.

- I COMPONENTI**
(Paste Pak Cartuccia)
- Cappuccio 2. Stantuffo interno 3. Puntali (Paste Pak Dispenser)
 - Pistone 5. Regolazione del dosaggio 6. Leva 7. Blocco di scorrimento 8. Leva di rilascio (Fig. 1)

- Prima dell'uso**
- Eliminare il nastro di fissaggio posto tra la parte principale e la leva del dispenser.
 - Togliere il cartone in forma di V dalla parte inferiore del dispenser.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Accertarsi che il pistone sia completamente ritratto nel dispenser. (Fig. 2)
Nota:
Per ritrarre il pistone, con le dita premere lo sgancio del pistone e contemporaneamente tirare il blocco scorrevole (posto nella parte inferiore dell'erogatore).
- Caricamento della cartuccia Paste Pak (Fig. 3)
 - Assicurarsi che il ▲ segno posto sulla cartuccia sia in linea con il ▲ segno posto sul Paste Pak Dispenser come illustrato.
 - Quindi, ruotare completamente la cartuccia verso destra.
Nota:
Per togliere la cartuccia, ritrarre completamente il pistone e ruotare la cartuccia fino a riportarla nelle posizioni contrassegnate.
- Dopo aver caricato la cartuccia far scorrere in avanti la leva di rilascio finché non si arresta. (Fig. 4)
 - Fare pressione sulla parte anteriore della leva di rilascio.
 - Non fare pressione sulla lato superiore.
- Togliere il cappuccio dalla cartuccia. (Fig. 5)
- Abbassare la leva per erogare le quantità di pasta necessarie sul blocchetto di miscelazione.
Nota:
1) Prima di erogare il materiale per la prima volta da una cartuccia nuova o dopo che è trascorso un lungo periodo di tempo dall'ultima erogazione, far fuoriuscire una piccola quantità di pasta dalla cartuccia. (Fig. 6)

- La guida di regolazione può essere spostata avanti o indietro per modificare la quantità di materiale da estrarre. (Fig. 7)
 - Posizionare la guida di regolazione sulla quantità necessaria per un inlay.
 - Posizionare la guida di regolazione sulla quantità necessaria per una corona.
- Mentre si preme la leva (Fig. 8-1), stendere e staccare il materiale estruso dalle punte della cartuccia portando la cartuccia e il distributore in posizione perpendicolare rispetto al blocchetto di miscelazione (Fig. 8-2).
Lorsque le levier est relâché après la distribution, les résidus de pâtes aux extrémités des cartouches se rétractent dans la cartouche. Nettoyez la pointe de la cartouche et remplacez le couvercle de la cartouche. (Fig. 9)
Note:
1) La cantidad de material residual en el cartucho puede confirmarse por la posición del bloque deslizante en la parte inferior del aplicador. Si los cilindros del cartucho son translúcidos, el material residual puede también verse por la posición del émbolo interior dentro de los mismos.
- No deje caer el aplicador con el cartucho. De lo contrario el cartucho podría estropearse.

Limpieza / Esterilización del dispensador Paste Pak Dispenser

- Limpie el dispensador y el tirador manual con una gasa empapada en alcohol.
- El dispensador puede esterilizarse en vapor en autoclave a 121-135°C (250-275°F) por 10 y 30 minutos o desinfectarse usando alcohol.
(Por favor, retire la guía de ajuste y el cartucho antes de esterilizar con autoclave el dispensador). No se recomiendan el uso de varios desinfectantes / esterilizantes químicos ya que pueden dañar el dispensador.
Nota:
Tras la esterilización en autoclave, la palanca de liberación puede no desplazarse fácilmente hacia delante y atrás con los dedos. Aplique una cantidad mínima de vaselina en toda la superficie del pistón. Después, mueva varias veces la palanca de liberación hacia adelante y atrás con el fin de asegurar un movimiento suave.

PRECAUCIONES

- En raros casos el metal puede causar sensibilidad en algunas personas. Si se experimenta alguna reacción, suspenda el uso del producto (níquel- chapado de aluminio) y diríjase al médico.
- Almacene el dispensador Paste Pak Dispenser lejos de productos químicos que contengan elementos halógenos, como la tintura de Yodo. De otro modo, el dispensador puede decolorarse.
- Siempre debe utilizarse un equipo de protección personal (PPE) como guantes, mascarillas y una protección adecuada de los ojos.

PRECAUTIONS

- In rare cases the metal puede causar sensibilidad en algunas personas. Si se experimenta alguna reacción, suspenda el uso del producto (níquel- chapado de aluminio) y diríjase al médico.
- Almacene el dispensador Paste Pak Dispenser lejos de productos químicos que contengan elementos halógenos, como la tintura de Yodo. De otro modo, el dispensador puede decolorarse.
- Siempre debe utilizarse un equipo de protección personal (PPE) como guantes, mascarillas y una protección adecuada de los ojos.

Algunos de los productos mencionados en las presentes instrucciones pueden clasificarse como peligrosos según GHS. Siempre familiarizarse con las hojas de datos de seguridad disponibles en:
<http://www.gceurope.com>
o para América
<http://www.gcamerica.com>
También se pueden obtener de su proveedor.

Informes de efectos no deseados:
Si tiene conocimiento de algún tipo de efecto no deseado, reacción o situaciones similares experimentados por el uso de este producto, incluidos aquellos que no figuran en esta instrucción para su uso, informólos directamente a través del sistema de vigilancia correspondiente, seleccionando la autoridad correspondiente de su país. Accesible a través del siguiente enlace:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
así como a nuestro sistema de vigilancia interna: vigilance@gc.dental
De esta forma contribuirás a mejorar la seguridad de este producto.
Última revisión: 08/2022

Informes de efectos no deseados:
Si tiene conocimiento de algún tipo de efecto no deseado, reacción o situaciones similares experimentados por el uso de este producto, incluidos aquellos que no figuran en esta instrucción para su uso, informólos directamente a través del sistema de vigilancia correspondiente, seleccionando la autoridad correspondiente de su país. Accesible a través del siguiente enlace:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
así como a nuestro sistema de vigilancia interna: vigilance@gc.dental
De esta forma contribuirás a mejorar la seguridad de este producto.
Última revisión: 08/2022

Informes de efectos no deseados:
Si tiene conocimiento de algún tipo de efecto no deseado, reacción o situaciones similares experimentados por el uso de este producto, incluidos aquellos que no figuran en esta instrucción para su uso, informólos directamente a través del sistema de vigilancia correspondiente, seleccionando la autoridad correspondiente de su país. Accesible a través del siguiente enlace:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
así como a nuestro sistema de vigilancia interna: vigilance@gc.dental
De esta forma contribuirás a mejorar la seguridad de este producto.
Última revisión: 08/2022

Informes de efectos no deseados:
Si tiene conocimiento de algún tipo de efecto no deseado, reacción o situaciones similares experimentados por el uso de este producto, incluidos aquellos que no figuran en esta instrucción para su uso, informólos directamente a través del sistema de vigilancia correspondiente, seleccionando la autoridad correspondiente de su país. Accesible a través del siguiente enlace:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
así como a nuestro sistema de vigilancia interna: vigilance@gc.dental
De esta forma contribuirás a mejorar la seguridad de este producto.
Última revisión: 08/2022

Informes de efectos no deseados:
Si tiene conocimiento de algún tipo de efecto no deseado, reacción o situaciones similares experimentados por el uso de este producto, incluidos aquellos que no figuran en esta instrucción para su uso, informólos directamente a través del sistema de vigilancia correspondiente, seleccionando la autoridad correspondiente de su país. Accesible a través del siguiente enlace:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
así como a nuestro sistema de vigilancia interna: vigilance@gc.dental
De esta forma contribuirás a mejorar la seguridad de este producto.
Última revisión: 08/2022

Informes de efectos no deseados:
Si tiene conocimiento de algún tipo de efecto no deseado, reacción o situaciones similares experimentados por el uso de este producto, incluidos aquellos que no figuran en esta instrucción para su uso, informólos directamente a través del sistema de vigilancia correspondiente, seleccionando la autoridad correspondiente de su país. Accesible a través del siguiente enlace:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
así como a nuestro sistema de vigilancia interna: vigilance@gc.dental
De esta forma contribuirás a mejorar la seguridad de este producto.
Última revisión: 08/2022

Informes de efectos no deseados:
Si tiene conocimiento de algún tipo de efecto no deseado, reacción o situaciones similares experimentados por el uso de este producto, incluidos aquellos que no figuran en esta instrucción para su uso, informólos directamente a través del sistema de vigilancia correspondiente, seleccionando la autoridad correspondiente de su país. Accesible a través del siguiente enlace:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
así como a nuestro sistema de vigilancia interna: vigilance@gc.dental
De esta forma contribuirás a mejorar la seguridad de este producto.
Última revisión: 08/2022

Informes de efectos no deseados:
Si tiene conocimiento de algún tipo de efecto no deseado, reacción o situaciones similares experimentados por el uso de este producto, incluidos aquellos que no figuran en esta instrucción para su uso, informólos directamente a través del sistema de vigilancia correspondiente, seleccionando la autoridad correspondiente de su país. Accesible a través del siguiente enlace:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
así como a nuestro sistema de vigilancia interna: vigilance@gc.dental
De esta forma contribuirás a mejorar la seguridad de este producto.
Última revisión: 08/2022

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. **IT**

Paste Pak Dispenser

