



CARTRIDGE DISPENSER II MIXING TIP II

Får endast användas av tandvårdspersonal enligt indikationerna för användning.

CARTRIDGE DISPENSER II samt MIXING TIP II används för att blanda och dosera den önskade mängden av antingen Vinylpolyeterisilikon (EXA'lençe) och vinyl polysiloxanbaserade avtrycks- eller reberaseringsmaterial (speciellt GC RELINE® Soft / Extra Soft).

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING
Dosering av GC vinylpolyeterisilikon eller vinylpolysi- loxanbaserade avtrycks- och reberaseringsmaterial från magasin (Cartridge Dispenser II benämns hädanefter nedan som 'dispenser').

BRUKSANVISNING

- Frigör läsmekanismen på dispensern och dra kolven bakåt.
- Lift patronhållaren och sätt patronen på dess plats. Försäkra dig om att den v-formade skåran på patronens fläns pekar nedåt. Tryck ner patronhållaren för att fixera patronen i dess korrekta läge.
- Frigör läsmekanismen på dispensern och tryck kolven framåt tills kontakt med patronen erhålles.
- Avlägsna locket på patronen genom att vrida den 1/4 varv motsols, vrid locket nedåt och avlägsna det från patronen helt och hållet. Dispensera försiktigt lite material från patronen. Försäkra dig om att det kommer material i jämn hastighet från patronens bägge öppningar.
- Rikta blandningsspetsens infattning mot den V-formade skåran mellan patronens två komponentcylindrar. Tryck stadigt fast blandningsspetsen. Roter sedan blandningsspetsens färgade krage 1/4 varv medsols tills den når patronen. Dispensern är nu färdig att användas.
- Pressa handtaget ett flertal gånger för att trycka ut blandat material. Efter användning, avlägsna inte blandningsspetsen då denna kommer att fungera som skydd tills materialet skall användas igen. När produkten skall användas igen, rotera blandningsspetsens krage 1/4 varv motsols för att linjra med den v-formade skåran på patronen. Fäll blandningsspetsen nedåt och avlägsna den från patronen.
- Ersätt den använda blandningsspetsen först innan produkten skall användas igen. Innan den nya spetsen sätts på plats, tryck försiktigt ut lite material för att säkerställa att både bas och katalyst flyter ut som den ska. Ifall detta misslyckas, avlägsna stelnat material från de områden på patronen där detta erfordras.
- Vid byte av patron, frigör läsmekanismen och dra kolven helt tillbaka. Ta bort patronen genom att lyfta upp patronhållaren. Ersätt den gamla patronen med en ny.

IDENTIFIERING AV DE OLIKA DELARNA

- Patronhållare
- Kolv
- Blandningsspetsens färgade krage
- Läsmekanism
- V-formad skåra på patronens fläns
- V-formad skåra mellan patronenscylindrar
- MIXING TIP II

ATT OBSERVERA

- Används endast efter kontroll av att patron samt blandningsspets sitter ordentligt fast på dispensern.
- Häftig och kraftfull dosering kan orsakafakturer i patronen. För att undvika detta, tryck försiktigt på handtaget för att pressa ut blandat material.
- Rengör dispensern med en etanolösning (för desinficering) eller en våt torkservett. Dispensern kan autoklaveras. Notera dock att vissa typer av autoklaver når över 132 °C och kan därför orsaka att plastdelarna deformeras. För exakta detaljer, kontakta tillverkaren av just er autoklav.
- Efter autoklavering, använd inte dispensern innan den svalnat till fullt.

FÖRPACKNINGAR

- BLANDNINGSPISTOL II 1 styck
- BLANDNINGSSPETSAR II SS (gula), 60 st.
- BLANDNINGSSPETSAR II S (rosa), 60 st.
- BLANDNINGSSPETSAR II LL (lila), 60 st.
- BLANDNINGSSPETSARI I L (grön / blå), 60 st.


Vissa produkter som hänvisas till i denna bruksanvisning kan klassificeras som farliga enligt GHS. Bekanta dig alltid med säkerhetsdatabladn som finns på: https://www.gc.dental/europe. De kan även erhallas från din leverantör.

REPORTERING AV ÖNSKADE EFFEKTER:

För sammanfattningen av Säkerhet och Klinisk prestation (SSCP) vår vänlig se EUDAMED databas(https://ec.eu/tools/eudamed) eller kontakta oss Regulatory.gce@gc.dental.

Reportering av önskade effekter:

Om du upptäcker någon form av önskade effekter, reaktioner eller liknade

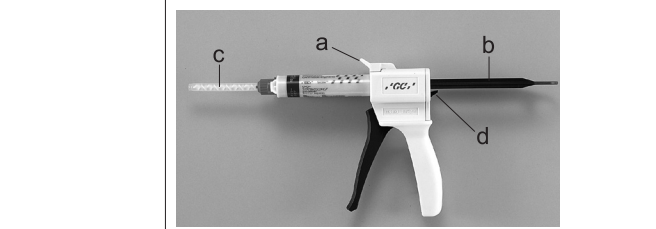

händelser som upplevs efter användning av denna produkt, inklusive de som inte är upplagna i denna bruksanvisning, rapportera dem direkt genom det relevanta vakningsstysstemet genom att välja länkarna behövs myndighet, finns tillgängligt via denna länk: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en såväl som vårt interna vaknings/medical-devices/contacts_en: vigilance@gc.dental

På detta sätt bidrar du till att förbättra säkerheten för denna produkt.

Reviderad senast : 06/2024

Antes de utilizar, leia cuidadosamente as instruções de utilização. **PT**

CARTRIDGE DISPENSER II MIXING TIP II

Para utilização apenas por um profissional dentário nas indicações de utilização.

O DOSEADOR DE CARTUCHO II e a PONTA MISTURADORA II são utilizados para misturar e dispensar a quantidade necessária de materiais de impressão e rebasamento à base de vinil poliéter silicone (EXA'lençe) ou vinil polissiloxano em cartucho (em particular GC RELINE® Soft / Extra Soft).

INDICAÇÕES

Doseamento de materiais de impressão à base de vinil poliéter silicone ou vinil polissiloxano e rebasamento da GC à base de vinil polissiloxano em cartuchos (o Doseador de Cartucho II será adiante referido como 'doseador').

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Levante a alavanca de libertação do doseador e puxe o êmbolo totalmente para trás, para o interior do doseador.
- Levante o suporte do cartucho do doseador e carregue o cartucho, assegurando-se de que a ranhura em forma de V no rebordado cartucho está voltada para baixo. Empurre o suporte do cartucho para baixo para fixar o cartucho.
- Levante a alavanca de libertação e empurre o êmbolo para a frente até que encaixe no cartucho.
- Retire a tampa do cartucho: rode a tampa 1/4 de volta no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, vire a tampa para baixo e solte-a do cartucho. Aperte suavemente a pega do doseador de modo a extrair uma pequena quantidade do material das duas aberturas na parte final do cartucho. Assegure-se de que a base e o catalisador saem uniformemente.
- Alinhe a ranhura em forma de V na aresta da PONTA MISTURADORA II com a ranhura em forma de V entre os canais do cartucho. Empurre com firmeza para encaixar a ponta misturadora. Em seguida, rode a gola colorida da ponta misturadora 1/4 de volta no sentido dos ponteiros do relógio até à ponta do cartucho. O doseador está agora pronto para ser utilizado.
- Aperte a pega várias vezes para extrair o material. Depois da utilização, não remova a PONTA MISTURADORA II dado que esta será a tampa de armazenamento até à próxima utilização. Ao substituir a PONTA MISTURADORA II, rode a gola da ponta misturadora 1/4 de volta no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio, de modo a alinhar a ranhura em forma de V no cartucho. Dobre a ponta misturadora para baixo e retire-a do cartucho.
- Retire e substitua a ponta misturadora utilizada imediatamente antes da utilização seguinte. Antes de colocar uma ponta nova, extraia suavemente uma pequena quantidade do material, para assegurar que a base e o catalisador saem de forma homogénea de ambas as aberturas. Caso não consiga extrair os materiais, retire qualquer material endurecido que se possa encontrar na ponta do cartucho.
- Para substituir o cartucho, levante a alavanca de libertação e retraia o êmbolo totalmente. Retire o cartucho vazio levantando o suporte do cartucho e coloque um novo cartucho no doseador.

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

- Suporte do cartucho
- Êmbolo
- Gola colorida da PONTA MISTURADORA II
- Alavanca de libertação
- Ranhura em forma de V entre os canais do cartucho
- Ranhura em forma de V no rebordo do cartucho
- PONTA MISTURADORA II

NOTAS

- Utilizar apenas depois de verificar que o cartucho e a ponta misturadora estão corretamente colocados no doseador.
- A extrusão rápida pode rachar o cartucho. Para evitar que isso aconteça, aperte suavemente a pega para extrair o material.
- Limpar o doseador com uma solução de etanol (para desinfetar) ou um toalhete dentário. O doseador pode ser esterilizado numa autoclave. Porém, o tratamento a temperaturas da câmara de esterilização pode atingir temperaturas de 132 °C ou superiores, podendo o material do doseador (resina sintética) deformar-se a essas temperaturas. Para mais pormenores, contacte o fabricante da sua autoclave.
- Depois de esterilizar na autoclave, não utilizar o doseador até que este tenha arrefecido completamente.

EMBALAGENS

- DOSEADOR DE CARTUCHO II 1 UNIDADE
- PONTA MISTURADORA II SS (amarela), 60 unidades

- PONTA MISTURADORA II S (rosa), 60 unidades
- PONTA MISTURADORA II LL (rosa), 60 unidades
- PONTA MISTURADORA II L (verde / azul), 60 unidades

Alguns produtos referidos nestas instruções de utilização podem ser classificados como perigosos de acordo com o GHS. Familiarize-se sempre com as fichas de dados de segurança disponíveis em: https://www.gc.dental/europe. Poderá ainda obtê-las junto do seu fornecedor.

Relatório de efeitos indesejados:

Se você tomar conhecimento de qualquer tipo de efeito indesejado, reação ou situações semelhantes experimentados pelo uso deste produto, incluindo aqueles não listados nesta instrução para uso, por favor comunique-os diretamente através do sistema de vigilância correspondente, selecionando a autoridade apropriada de seu país. acessível através do seguinte link: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en bem como ao nosso sistema interno de vigilância: vigilance@gc.dental

Desta forma, você contribuirá para melhorar a segurança deste produto.

Última revisão : 06/2024

Πριν από τη χρήση παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. **EL**

Πριν από τη χρήση παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. **EL**

Πριν από τη χρήση παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. **EL**

CARTRIDGE DISPENSER II MIXING TIP II

Για χρήση μόνο από επαγγελματία οδοντίατρο στις ενδείξεις χρήσης.

Το πιστόλι δοσομέτρησης CARTRIDGE DISPENSER II και το ρύγχος ανάμιξης MIXING TIP II χρησιμοποιούνται για την ανάμιξη και δοσομέτρηση της απαιτούμενης ποσότητας υλικού τύπου βινυλολυσαιθερ ολικόνης (EXA'lençe) από τη φύσιγγα και αποτυπωτικών υλικών τύπου βινυλολυσαιζόνης και υλικών αναγόμωσης βάσης (ειδικά για τα GC RELINE® Soft / Extra Soft).

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Δοσομέτρηση των υλικών GC βινυλολυσαιθερ ολικόνης ή βινυλολυσαιζόνης και υλικών αναγόμωσης βάσης από φύσιγγες (το πιστόλι δοσομέτρησης- Cartridge Dispenser II- αναφέρεται ως «πιστόλι» από εδώ και στο εξής).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Ανασηκώστε το μοχλό απελευθέρωσης του δοσομετρητή και τραβήξτε το έμβολο τελείως πίσω στην αρχική τουθέση.
- Ανασηκώστε το συγκρατητήρα της φύσιγγας του δοσομετρητή και εδράστε τη νέα φύσιγγα βεβωώνοντας ότι η εγκοπή σχήματος -V-της, περιφέρειας του άκρου της φύσιγγας κοπή προς τα κάτω. Πιέστε προς τα κάτω το συγκρατητήρα της φύσιγγας ώστε αυτή να ασφαλισι στη θέση της.
- Ανασηκώστε το μοχλό απελευθέρωσης και πιέστε στη σκανδάλη του δοσομετρητή ώστε το έμβολο να ακουμπήσει στη φύσιγγα.
- Αφαιρέστε το καπάκι της φύσιγγας περιστρέφοντάς το κατά 1/4 αριστερόστροφα, τραβήξτε το προς τα κάτω και μακριά από τη φύσιγγα. Πιέστε ελαφρά τη σκανδάλη του δοσομετρητή για την εξώθηση μικρής ποσότητας υλικού και από τα δύο στόμια του άκρου της φύσιγγας. Βεβαιωθείτε ότι η βάση και ο καταλύτης εξέρχονται ομοιόμορφα.
- Ευθυγραμμίστε την εγκοπή σχήματος -V- του χειλούς του ΡΥΓΧΟΥΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ II με το σχήμα -V- μεταξύ των δύο χωρητικοτήτων της φύσιγγας. Πιέστε σταθερά για την εφαρμογή του ρύγχους ανάμιξης. Στη συνέχεια περιστρέψτε το εγχώριο κολάρο του ρύγχους ανάμιξης κατά 1/4 δεξιάστροφα μέχρι το πέρας της κίνησης. Ο δοσομετρητής είναι τώρα έτοιμος προς χρήση.
- Πιέστε τη σκανδάλη αρκετές φορές για την εξώθηση υλικού. Μετά τη χρήση μην αφαιρέτε το ΡΥΓΧΟΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ II από αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καπάκι φύλιξης μέχρι την επόμενη χρήση. Κατά την αντικατάσταση του ΡΥΓΧΟΥΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ II, περιστρέψτε το κολάρο κατά 1/4 αριστερόστροφα ευθυγραμμίζοντας την εγκοπή σχήματος -V- με αυτήν στο άκρο της φύσιγγας. Πιέστε το ρύγχος ανάμιξης προς τα κάτω και τραβήξτε το μακριά από τη φύσιγγα.
- Αφαιρέστε και αντικαταστήστε το παλιό ρύγχος ανάμιξης αμέσως πριν από τη νέα χρήση. Πριν από την τοποθέτηση του νέου ρύγχους, εξουδένστε μικρή ποσότητα υλικού για να βεβαιωθείτε ότι η βάση και ο καταλύτης εξέρχονται ομοιόμορφα και από τα δύο στόμια. Αν τα υλικά δεν εξέρχονται αφαιρέστε τυχόν σκληρωμένη ποσότητα υλικού από τα δύο στόμια.
- Για την αντικατάσταση της φύσιγγας ανασηκώστε το μοχλό απελευθέρωσης και τραβήξτε τελείως πίσω το έμβολο. Αφαιρέστε την άδεια φύσιγγα και τοποθετήστε στο δοσομετρητή τη νέα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

- Συγκρατητήρας Φύσιγγας
- Έμβολο προώθησης
- Εγχώριο κολάρο ΡΥΓΧΟΥΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ II
- Μοχλός απελευθέρωσης
- Εγκοπή σχήματος -V- μεταξύ των δύο χωρητικοτήτων της φύσιγγας
- Εγκοπή σχήματος -V- στο άκρο της φύσιγγας
- ΡΥΓΧΟΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ II

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η χρήση πρέπει να επιχειρείται μόνο μετά από έλεγχο ότι η φύσιγγα και το ρύγχος ανάμιξης είναι με ασφάλεια τοποθετημένα στο δοσομετρητή. Εξαιρετική εξώθηση υλικού μπορεί να προκαταέσει κάταγμα της φύσιγγας. Για την αποφυγή αυτού του συμβάντος πιέστε μαλακά για την σκανδάλη για την εξώθηση υλικού.
- Καθαρίστε το δοσομετρητή με διάλυμα αιθανόλης (για απολύμανση) ή οδοντιατρικής χρήσης υγρά μονητλικά. Ο δοσομετρητής μπορεί να αποστειρωθεί σε αυτόκαυστο κλιβάνο. Ωστόσο με κλίσιους αυτόκαυστους κλιβάνους ή θερμικρασία του θάλαμου αποστειρωσης μπορεί να φθάσει τους 132 °C ή υψηλότερα και υπάρχει η πιθανότητα το υλικά κατασκευής του δοσομετρητή (συνθετική ρητίνη) να στρεβλωθεί σε αυτές τις θερμοκρασίες. Για λεπτομέρειες απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του αυτόκαυστου κλιβάνου.
- Μετά την αποστέρωση μην χρησιμοποιήσετε το δοσομετρητή μέχρι να κρυώσει τελείως.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Δοσομετρητής, Dispenser II 1 τεμ
- ρύγχος ανάμιξης II SS(κίτρινο), 60 τεμάχια
- ρϋγχος αναμειξης II S(ροζ), 60 τεμάχια
- ρϋγχος αναμειξης II LL (μωβ), 60 τεμάχια
- ρϋγχος αναμειξης II L(πράσινο/μπλε), 60 τεμάχια

Για την Περιλήψη της Ασφάλειας καιΟρισμένα προϊόντα που αναφέρονται στην παρούσα ΓΧΠ ενδέχεται να ταξινομηθούν ως επικίνδυνα σύμφωνα με το GHS. Να εξοικειώνστε πάντα με τα δελτία δεδομένων ασφαλείας που είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση: https://www.gc.dental/europe.

Μπορείτε επίσης να τα προμηθευτείτε από τον προμηθευτή σας.

Για την Περιλήψη της Ασφάλειας και της Κλινικής Απόδοσης (SSCP) ανατρέξτε στη βάση δεδομένων EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) ή επικοινωνήστε μαζί μας στο Regulatory.gce@gc.dental.

Αναφορά για ανεπιθύμητες ενέργειες:

Αν ενιμερωθείτε για οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, αντίδραση ή παρόμοια γεγονόςα από τη χρήση του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων και όσων δεν αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης, παρακαλούμε δηλώσατε τις αμέσως στο ειδικό σύστημα επιλέγοντας την κατάλληλη αρχή της χώρας σας που μπορείτε να βρείτε μέσα από την ακόλουθη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en καθώς και στο εσωτερικό σύστημα ασφαλείας της εταιρείας: vigilance@gc.dental

Με τον τρόπο αυτό συντελείτε στην βελτίωση της ασφάλειας χρήσης αυτού του προϊόντος.

For sammendraget av Sikkerhet og Klinisk prestasjon, vennligst se EUDAMED database (https://ec.eu/tools/eudamed) eller kontakt oss på Regulatory.gce@gc.dental.

RAPPORTERING AV BIVIRKNINGER:
Av eniμερωθείτε για οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, αντίδραση ή lignende opplevelser ved bruk av dette produktet, inkludert de som ikke er oppgitt i denne bruksanvisningen, ber vi deg rapportere de direkte gjennom biviρningsregisteret så da velge riktig instans i landet ditt: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en så vel som vårt interne arnkerhetsstystem: vigilance@gc.dental
På denne måten vil du bidra til å forbedre sikkerheten til dette produktet

For sammendraget av Sikkerhet og Klinisk prestasjon, vennligst se EUDAMED database (https://ec.eu/tools/eudamed) eller kontakt oss på Regulatory.gce@gc.dental.

For sammendraget av Sikkerhet og Klinisk prestasjon, vennligst se EUDAMED database (https://ec.eu/tools/eudamed) eller kontakt oss på Regulatory.gce@gc.dental.

For sammendraget av Sikkerhet og Klinisk prestasjon, vennligst se EUDAMED database (https://ec.eu/tools/eudamed) eller kontakt oss på Regulatory.gce@gc.dental.

For sammendraget av Sikkerhet og Klinisk prestasjon, vennligst se EUDAMED database (https://ec.eu/tools/eudamed) eller kontakt oss på Regulatory.gce@gc.dental.

For sammendraget av Sikkerhet og Klinisk prestasjon, vennligst se EUDAMED database (https://ec.eu/tools/eudamed) eller kontakt oss på Regulatory.gce@gc.dental.

Les bruksanvisningen nøye før bruk. **NO**

CARTRIDGE DISPENSER II MIXING TIP II

Brukes kun av tannhelsepersonell ifølge anbefalte indikasjoner.

For sammendraget av Sikkerhet og Klinisk prestasjon, vennligst se EUDAMED database (https://ec.eu/tools/eudamed) eller kontakt oss på Regulatory.gce@gc.dental.

For sammendraget av Sikkerhet og Klinisk prestasjon, vennligst se EUDAMED database (https://ec.eu/tools/eudamed) eller kontakt oss på Regulatory.gce@gc.dental.

CARTRIDGE DISPENSER II og MIXING TIP II brukes til å blande og dispensere den nødvendige mengden av vinylpolyeterisilikon fra patron (EXA'lençe) og vinylpolysiloksanavtrykk (EXACLEAR) og relinematieraler (specielt GC RELINE® Soft / Extra Soft).

INDIKASJONER FOR BRUK

Dispensering av GC vinyl polyeter silisium eller vinyl polysiloksan avtrykk og relinematieraler fra patroner (patrondispenseren II refereres til som 'dispenser' heretter)

BRUKSANVISNING

- Løft utløserspaken til dispenseren og trek stempel et helt tilbake inn i dispenseren.
- Løft patronholderen til dispenseren og sett inn patronen og pass på at det V-formede hakket på flensen på patronen vender ned. Skvy ned patronholderen for å fiksere patronen.
- Løft utløserspaken og skyv stempellet forover til det girper inn i patronen.
- Fjern patronlokket ved å dreie 1/4 omdreining mot klokken, vipp lokket nedover og dra det vekk fra patronen. Klem forsiktig på dispenserhåndtaket for å presse ut en liten mengde materiale fra de to åpningene på enden av patronen. Pass på at base og katalysator kommer jevnt ut.
- Juster det V-formede hakket på kanten av MIXING TIP II med det V-formede hakket mellom patronhysene. Trykk godt for å feste blandepissen. Roter deretter den fargede krage på blandepissen 1/4 omdreining med klokken til enden av patronen. Dispenseren er nå klar til bruk.
- Klem håndtaket flere ganger for å ekstrudere materialet. Etter bruk, ikke fjern MIXING TIP II, da dette vil bli korken før neste bruk. Når du bytter ut MIXING TIP II, dreier du kragen på blandepissen 1/4 omdreining mot klokken for å justere det V-formede hakket på patronen. Vipp blandepissen nedover og fjern den fra patronen.
- Fjern og skift ut den gamle blandepissen umiddelbart før neste bruk. For du fester en ny spiss, ekstruder en liten mengde materiale forsiktig for å sikre at basen og katalysatoren flyter jevnt fra begge åpningene. Hvis materialene ikke klarer å ekstrudere, fjern eventuelt herdet materiale på enden av kassetten.
- For å skifte patron skal utløserspaken løftes og stempellet trekkes helt tilbake. Fjern den tomme patronen ved å løfte stempelmagasinet og legge en ny inn i dispenseren.

IDENTIFIKASJON AV DELER

- Patronholder
- Stempel
- Farget krage for BLANDESPISS II
- Utløser spakken
- V-formet hakke på flensen til patronen
- V-formet hakke mellom patronhysene
- V-formet hakk på kanten av MIXING TIP II

MERKNADER

- Bruk kun etter å ha kontrollert at patronen og blandepissen er satt godt inn i dispenseren.
- Plutselig ekstrudering kan forårsake sprekker i patronen. For å unngå dette, klem forsiktig på håndtaket for å ekstrudere materialet.
- Rengjør dispenseren med en etanoløsning (for desinfisering) eller dental våtserviett. Dispenseren kan steriliseres i en autoklav. Men med noen autoklaver kan temperaturen i steriliseringskammeret nå 132 °C eller høyere, og det er en mulighet for at dispenserematerialet (syntetisk harpiks)

kan bli ødelagt ved disse temperaturene. For detaljer, kontakt produsenten av autoklaven.

4. Bruk ikke dispenseren for den er helt avkjølt etter autoklavering.

PAKNING

- CARTRIDGE DISPENSER II 1 stykk
- BLANDESPISS II SS (gul), 60 stykk
- BLANDESPISS II S (rosa), 60 stykk
- BLANDESPISS II LL (lilla), 60 stykk
- BLANDESPISS II L (grønn / blå), 60 stykk

Noen av produktene som er referert til i denne IFU kan være klassifisert som skadelige i henhold til GHS. Gjør deg alltid kjent med sikkerhetsdatabladene som er tilgjengelige hos: https://www.gc.dental/europe.

De kan også hentes fra din leverandør.

For sammendraget av Sikkerhet og Klinisk prestasjon, vennligst se EUDAMED database (https://ec.eu/tools/eudamed) eller kontakt oss på Regulatory.gce@gc.dental.

RAPPORTERING AV BIVIRKNINGER:
Av eniμερωθείτε για οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, αντίδραση ή lignende opplevelser ved bruk av dette produktet, inkludert de som ikke er oppgitt i denne bruksanvisningen, ber vi deg rapportere de direkte gjennom biviρningsregisteret så da velge riktig instans i landet ditt: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en så vel som vårt interne arnkerhetsstystem: vigilance@gc.dental
På denne måten vil du bidra til å forbedre sikkerheten til dette produktet

For sammendraget av Sikkerhet og Klinisk prestasjon, vennligst se EUDAMED database (https://ec.eu/tools/eudamed) eller kontakt oss på Regulatory.gce@gc.dental.

RAPPORTERING AV BIVIRKNINGER:
Av eniμερωθείτε για οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, αντίδραση ή lignende opplevelser ved bruk av dette produktet, inkludert de som ikke er oppgitt i denne bruksanvisningen, ber vi deg rapportere de direkte gjennom biviρningsregisteret så da velge riktig instans i landet ditt: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en så vel som vårt interne arnkerhetsstystem: vigilance@gc.dental
På denne måten vil du bidra til å forbedre sikkerheten til dette produktet

RAPPORTERING AV BIVIRKNINGER:
Av eniμερωθείτε για οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, αντίδραση ή lignende opplevelser ved bruk av dette produktet, inkludert de som ikke er oppgitt i denne bruksanvisningen, ber vi deg rapportere de direkte gjennom biviρningsregisteret så da velge riktig instans i landet ditt: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en så vel som vårt interne arnkerhetsstystem: vigilance@gc.dental
På denne måten vil du bidra til å forbedre sikkerheten til dette produktet

RAPPORTERING AV BIVIRKNINGER:
Av eniμερωθείτε για οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, αντίδραση ή lignende opplevelser ved bruk av dette produktet, inkludert de som ikke er oppgitt i denne bruksanvisningen, ber vi deg rapportere de direkte gjennom biviρningsregisteret så da velge riktig instans i landet ditt: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en så vel som vårt interne arnkerhetsstystem: vigilance@gc.dental
På denne måten vil du bidra til å forbedre sikkerheten til dette produktet

RAPPORTERING AV BIVIRKNINGER:
Av eniμερωθείτε για οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, αντίδραση ή lignende opplevelser ved bruk av dette produktet, inkludert de som ikke er oppgitt i denne bruksanvisningen, ber vi deg rapportere de direkte gjennom biviρningsregisteret så da velge riktig instans i landet ditt: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en så vel som vårt interne arnkerhetsstystem: vigilance@gc.dental
På denne måten vil du bidra til å forbedre sikkerheten til dette produktet

RAPPORTERING AV BIVIRKNINGER:
Av eniμερωθείτε για οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, αντίδραση ή lignende opplevelser ved bruk av dette produktet, inkludert de som ikke er oppgitt i denne bruksanvisningen, ber vi deg rapportere de direkte gjennom biviρningsregisteret så da velge riktig instans i landet ditt: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en så vel som vårt interne arnkerhetsstystem: vigilance@gc.dental
På denne måten vil du bidra til å forbedre sikkerheten til dette produktet

RAPPORTERING AV BIVIRKNINGER:
Av eniμερωθείτε για οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, αντίδραση ή lignende opplevelser ved bruk av dette produktet, inkludert de som ikke er oppgitt i denne bruksanvisningen, ber vi deg rapportere de direkte gjennom biviρningsregisteret så da velge riktig instans i landet ditt: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en så vel som vårt interne arnkerhetsstystem: vigilance@gc.dental
På denne måten vil du bidra til å forbedre sikkerheten til dette produktet

RAPPORTERING AV BIVIRKNINGER:
Av eniμερωθείτε για οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, αντίδραση ή lignende opplevelser ved bruk av dette produktet, inkludert de som ikke er oppgitt i denne bruksanvisningen, ber vi deg rapportere de direkte gjennom biviρningsregisteret så da velge riktig instans i landet ditt: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en så vel som vårt interne arnkerhetsstystem: vigilance@gc.dental
På denne måten vil du bidra til å forbedre sikkerheten til dette produktet

RAPPORTERING AV BIVIRKNINGER:
Av eniμερωθείτε για οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, αντίδραση ή lignende opplevelser ved bruk av dette produktet, inkludert de som ikke er oppgitt i denne bruksanvisningen, ber vi deg rapportere de direkte gjennom biviρningsregisteret så da velge riktig instans i landet ditt: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en så vel som vårt interne arnkerhetsstystem: vigilance@gc.dental
På denne måten vil du bidra til å forbedre sikkerheten til dette produktet

RAPPORTERING AV BIVIRKNINGER:
Av eniμερωθείτε για οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, αντίδραση ή lignende opplevelser ved bruk av dette produktet, inkludert de som ikke er oppgitt i denne bruksanvisningen, ber vi deg rapportere de direkte gjennom biviρningsregisteret så da velge riktig instans i landet ditt: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en så vel som vårt interne arnkerhetsstystem: vigilance@gc.dental
På denne måten vil du bidra til å forbedre sikkerheten til dette produktet

RAPPORTERING AV BIVIRKNINGER:
Av eniμερωθείτε για οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, αντίδραση ή lignende opplevelser ved bruk av dette produktet, inkludert de som ikke er oppgitt i denne bruksanvisningen, ber vi deg rapportere de direkte gjennom biviρningsregisteret så da velge riktig instans i landet ditt: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en så vel som vårt interne arnkerhetsstystem: vigilance@gc.dental
På denne måten vil du bidra til å forbedre sikkerheten til dette produktet</